
快速启动向导

CN

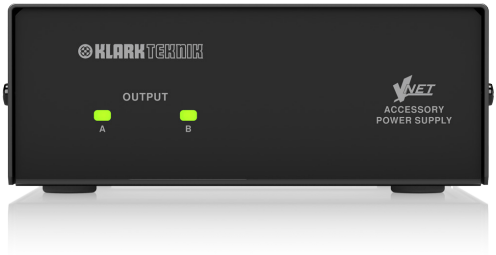

VNET INTERFACE POWER SUPPLY

Power Supply for VNET Interface Devices

V 3.0

KLARK TEKNIK

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

简介 / 主要特点


本产品旨在为一系列 Klark Teknik VNET™ 配件提供直流电源。它装在一个方便，坚固的钢制外壳中，可以独立使用，也可以使用机架安装套件，与最多两个配套附件产品一起放在机架上，所有这些都在 1U 的机架空间内。

- 可为一两个配件供电
- 坚固的钢制外壳
- 独立式或机架安装选项


连接配件

本产品有两个直流输出，其中任何一个都可用于为兼容附件供电。通过使用两个输出，可以同时为两个附件供电。一个电源不能为两个以上的附件供电。

使用随附的一根 3.5 毫米插孔电缆将输出之一连接到附件的 EXT DC 插孔，如图 1 所示：

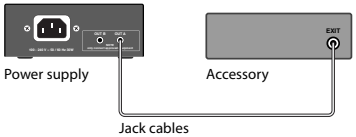

或使用两根插孔电缆连接两个附件，如图 2 所示：

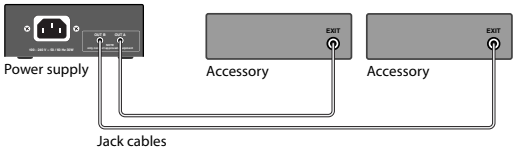

警告：在安装或操作设备之前，请参阅底部外壳外部信息以了解电气和安全信息。


CN

货架


VNET™ 接口和附件电源可以独立使用。如果您希望将它们安装在 19 英寸机架中，则可以使用附件安装套件。要在安装套件面板中安装附件：




1. 通过卸下两个螺母，卸下覆盖要安装附件的孔的两个安装支架和 Lexan 盲板。(保留这些以及螺钉和垫圈)。



2. 从附件一侧卸下两颗螺钉。

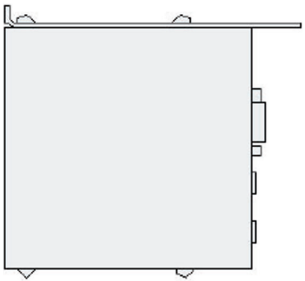

3. 使用 2 中卸下的两颗螺钉，将一个安装支架松散地连接到附件的一侧，“耳朵”朝前，指向外。

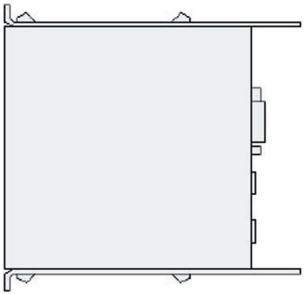

4. 对另一侧重复 2 和 3。现在将盖子推向设备后部尽可能远，然后将支架耳与盖子的前边缘对齐。现在拧紧螺丝。



5. 将附件及其安装支架提供到安装面板的背面，并使用 1 中拆下的两组螺钉、垫圈和螺母将其固定到位。

CN

手术

电源的每个输出都有一个指示灯。当设备正常运行时，它们都会亮起。如果其中一个指示灯不亮，这可能意味着输出已短路。检查插孔导线每一端的连接是否正确，并且电缆没有损坏。

快速开始

- 将插孔导线连接到附件
- 连接主电源

CN

技术参数

电源	
输入范围	100-240 V~
频率	50/60 Hz
消费	30 W
联系	3 极 IEC
输出	
电压	
12 V DC 标称	
当前的	最大 500 毫安 每个输出
连接	3.5 毫米插孔(尖端 +)
环境的	
温度	0 to +45 °C
湿度	0 to 80% RH (非冷凝)
身体的	
方面	45 x 117 x 117 (1.8 x 4.6 x 4.6")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。